



校正証明書

作成日: 2014/1/1
発行: 1/1
SAMPLE

エイキット・トレサ 株式会社 殿

エイキット・トレサ株式会社
岐阜県大垣市今宿6-52-18
ワークショップ24
TEL (0584) 71-9470
FAX (0584) 71-9471



品名	外側マイクロメータ	校正日	*****
型番	0-25mm	温湿度	20.1 °C 44 %
メーカー名	株式会社 ミットヨ	校正者	松下 武士
製造番号	*****	承認者	久保田 光治
管理番号	*****	判定	OK

上記の計測機器は、弊社の「点検校正作業標準」に基づいて校正が行われたことを証明します。使用基準器は、弊社の「基準器管理標準」に基づいて管理され、直接もしくはメーカーを経由して、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関や、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に定期的にトレーサビリティがとれています。

使用基準器

基準器名	メーカー名	型番	製造番号	基準器管理No.	有効期限
ゲージブロック	ミットヨ	BM1-10N-0	1002560	CS01005	2012/05
光学平行器	ミットヨ	OP-25/12.00	010046	CS01006	2012/06

検査結果

1. 器差

測定箇所 (mm)	判定精度	測定値	判定
0	±2	0	OK
5	±2	-1	OK
10	±2	-1	OK
15	±2	-1	OK
20	±2	-2	OK
25	±2	-1	OK

2. 平行度

判定精度	測定値	判定
2	0	OK

3. 平面度


測定箇所	判定精度	測定値	判定
アンビル	0.6	0.6	OK
スピンドル	0.6	0.6	OK

トレーサビリティ体系図

エイキット・トレサ株式会社
岐阜県大垣市今宿6-52-18

TEL (0584) 719470
FAX (0584) 719471

SAMPLE

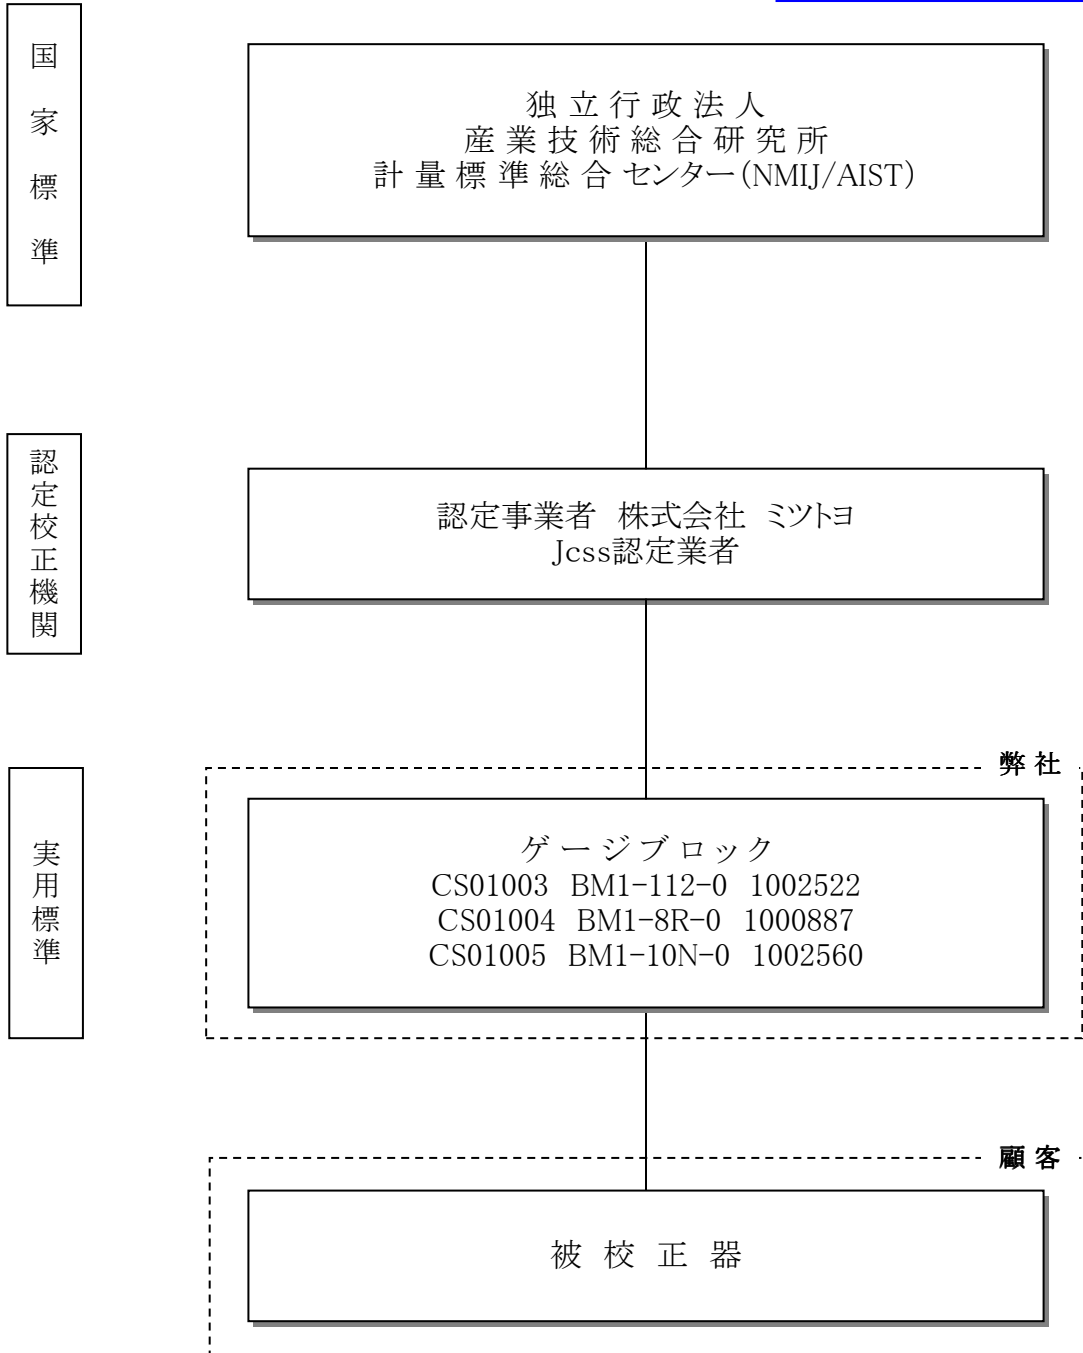

トレーサビリティ体系図

エイキット・トレサ株式会社
岐阜県大垣市今宿6-52-18

TEL (0584) 71-9470
FAX (0584) 71-9471

SAMPLE

国家標準

認定校正機関

実用標準

